


PROTOKOL O PŘEDÁNÍ REKOMBINANTNÍHO

PROTEINU VP60 RHDV1

Předávající	Veterinární univerzita Brno Ústav infekčních chorob a mikrobiologie Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Přejímající	Bioveta, a.s. Komenského 212/12 683 23 Ivanovice na Hané
Název	Rekombinantní Vp60 RHDV1
Původ	CZ kmen RHDV1 (Bioveta a.s.)
Antibiotická rezistence	-
Datum přípravy	11-12/2024
Kultivační médium	Resuspendováno v PBS
Sterilita	nesterilní
Množství	1 ampule/1ml, 10µg/ml rekombinantního proteinu
Datum předání	13. 12. 2024


V Brně dne 23.12.2024

Předal:

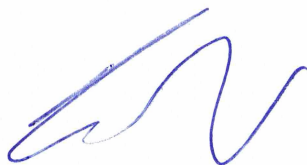

Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Ústav infekčních chorob a mikrobiologie
Veterinární univerzita Brno

Převzal:




MVDr. Jiří Nepeřený, Ph.D.
Bioveta, a.s.
Ivanovice na Hané

Technická specifikace

MW=60.23kDa, PI=4.9

MEGKARAAPQGEAAGTATTASVPGTTTDGMDPGVVATTSVITAENSSASIATAGIGG
PPQQVDQQETWRTNFFYYNDVFTWSVADAPGSILYTVQHSPQKNPFTAVLSQMYAG
WAGGMQFRFIVAGSGVFGGRLVAAVIPPGIEIGPGLEVRQFPHVVIDARSLEPVTI
TMPDLRPNMYHPTGDPGLVPTLVLSVYNNLINPFGGSTSAIQVTVETRPSEDFEFVMI
RAPSSKTVDSPAGLLTTPDLTGVGNDNRWNGQIVGLQVPVGGFSTCNRHWNLNLS
TYGWSSPRFADIDHRKGSASYTGSNATNVLQFWYANAGSAIDNPISQVAPDGF
PDMSFVPFNGPGIPAAGWVGFGAIWNSNSGAPNVTTVQAYELGFATGAPGNLQPTTN
TSGAQTVAKSIYAVVTGTAQNPAGLFVMASGHIISTPNASAITYPQPDRIVTTPGTPAA
APVGKNTPIMFASVVRRTGDVNATAGSVNGTQYGTGSQPLPVTIGLSLNNYS
SALMPGQFFVWQLTFASGFMEIGLSVDGYFYAGTGASTTLIDLTELIDVRPVGPRPSK
STLVFNLGGTANGFSYV

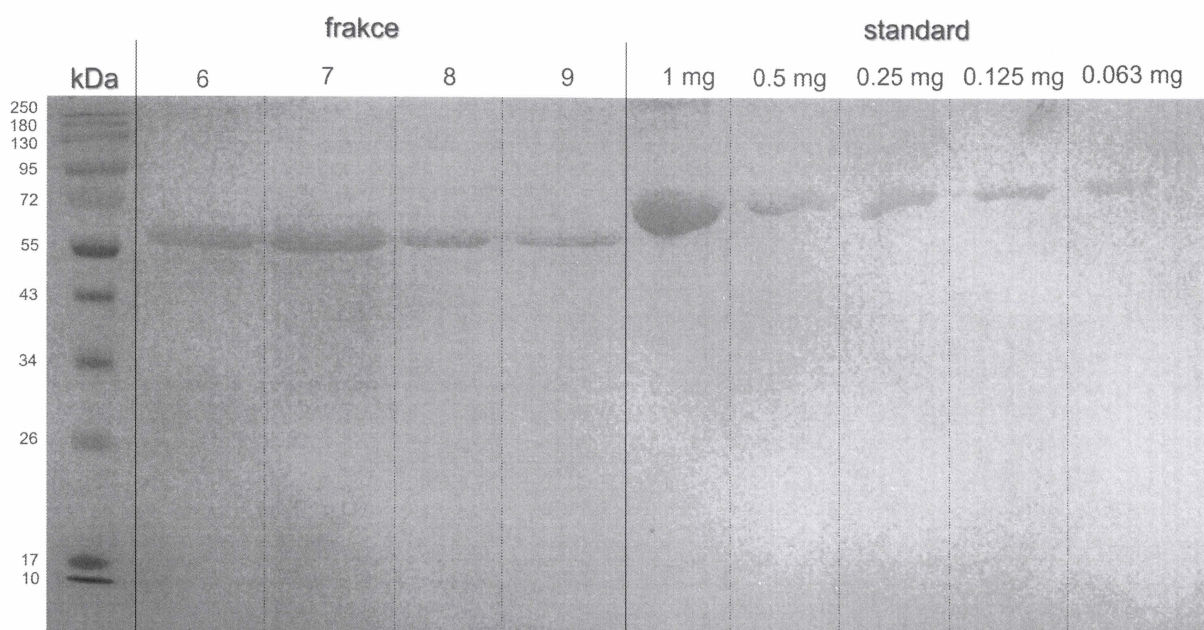

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ REKOMBINANTNÍHO PROTEINU VP60 RHDV2

Předávající	Veterinární univerzita Brno Ústav infekčních chorob a mikrobiologie Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
Přejímající	Bioveta, a.s. Komenského 212/12 683 23 Ivanovice na Hané
Název	Rekombinantní Vp60 RHDV1
Původ	CZ kmen RHDV2 (Bioveta a.s.)
Antibiotická rezistence	-
Datum přípravy	11-12/2024
Kultivační médium	Resuspendováno v PBS
Sterilita	nesterilní
Množství	1 ampule/1ml, 100µg/ml rekombinantního proteinu
Datum předání	13. 12. 2024


V Brně dne 23.12.2024

Předal:



Prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Ústav infekčních chorob a mikrobiologie
Veterinární univerzita Brno

Převzal:



MVDr. Jiří Nepeřený, Ph.D.
Bioveta, a.s.
Ivanovice na Hané

Technická specifikace

MW=60.23kDa, PI=4.9

MEGKARAAPQGETAGTATTASVPGTTTDDGMDPGVVATTSVVTTE
 NASTSIATAGIGGPPQQVDQQETWRTNFFYYNDVFTWSVADAPGNILYTVQHSPQNNPF
 TAVLSQMYAGWAGGMQFRFIVAGSGVFGGRLVAAVIPPGEIGPGLEVRQFPHVVIDA
 RSLPEVTITMPDLRPNMYHPTGNPGLVPTLVLSVYNNLINPFGGSTSAIQVTVETRPS
 EDFEFVMIRAPSSKTVDSISPADLLTTPVLTGVGTDNRWNGEIVGLQPVPGGFSTCNR
 HWNLNGSTFGWSSPRFAAIDHDRGNASFPGSSSSNVLELWYASAGSAADNPISQIAPD
 GFPDMSFVPFSGTTVPTAGWVGFGGIWNSSNGAPYVTTVQAYELGFATGAPSNPQPTT
 TTGAQIVAKSIYGVATGINQTTAGLFVMASGVISTPNSSAITYPQPNRIVNAPGTP
 AAAPIGKNTPIMFASVVRRTGDINAEAGSTNGTQYGAGSQPLPVTVGLSLNNYSSALV
 PGQFFVWQLNFASGFMEGLSVDGYFYAGTGASATLIDLSELVDIRPVGPRPSTSTLVYNLGG
 TTNGFSYV

